

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.01.2022

İhale Kodu :21105  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
  - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
  - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
  - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
  - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
  - 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
  - 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
  - 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
  - 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.
- NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **12.01.2022** tarih saat **17:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPA SETİ ÇİFTLİ	1400	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**


Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## ÇİFT KANALLI İNFÜZYON POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Pompa seti, kaset mekanizmalı olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalama odasına sahip olmalıdır.Kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır.Setin kaset mekanizması 2 ml.'ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır.
- 2.Kaset mekanizması sayesinde set,gönderim esnasında kesinlikle ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşullar altında ,gönderim doğruluğundan sapmadan,stabil ve sorunsuz olarak48 saat kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Kasetli set çift kanallı/ Yollu olmalı,tek setle iki farklı sıvıyı alıp,kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda;aynı kanaldan, aynı anda veya ardışık olarak dağılabilme özelliğine sahip olmalıdır.Setin sekonder hattı (2.sıvı giriş yeri) diğer setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.
- 4.Setin sekonder hattı (2.sıvı giriş yeri) gerektiğinde needle-free(iğnesiz)aparat ve konektörlerin girişlerine uygun olmalıdır.
- 5.Kasetli set ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır,gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır.( Maksimum Yüzde üç sapma oranı)
- 6.set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır;bu sayede sistem enfeksiyondan,ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.
- 7.Kasetli set infüzyon pompasına bağlandığında ,sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.
- 8.Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine ,distal basınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır.
- 9.set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir.Set,pampasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır.Set steril ve non-projenik olmalıdır.
- 10.İhalete iştirak eden firma ürünü ile ilgili uluslar arası platformlarda yapılmış klinik değerlendirme ve klinik çalışmalar sunmalıdır.İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır
- 11.ürünün ambalajı üzerind Spsyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bakanlığı ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmamış ürün numarası ( barkod) bulunmalıdır.
- 12.İhaleyi alan firma en az 200 (ikiyüz) set karşılığı 1 (bir) infüzyon pompa cihazını setlerin kullanım süresi boyunca Hastaneye kurmalıdır.

Batikan ELMAS  
Hemşire

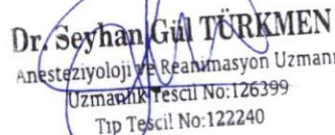

  
Dr. Seyhan Gül TÜRKMEN  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Uzmanlık Tescil No:126399  
Tıp Tescil No:122240

  
Zm. Dr. Erhan RSLAN ESTİM  
Uzman  
D. Erhan RSLAN ESTİM  
Tıp Tescil No:122240